


# 他院で施術されたインプラント

インプラントの被せ物に銀歯を使用した場合、衝撃によりインプラントボディが折れてしまうことがあります。折れたボディの一部が残ってしまうこともあります。

セラミックの被せ物を使用した場合は、過度な衝撃を受けた場合にボディへの衝撃を避けるためセラミックの被せ物が割れ、ボディへの衝撃を緩和し破損を防ぐことができます。

また、ボディが折れることもないため、当院では安全なセラミックにのみ使用となっております。

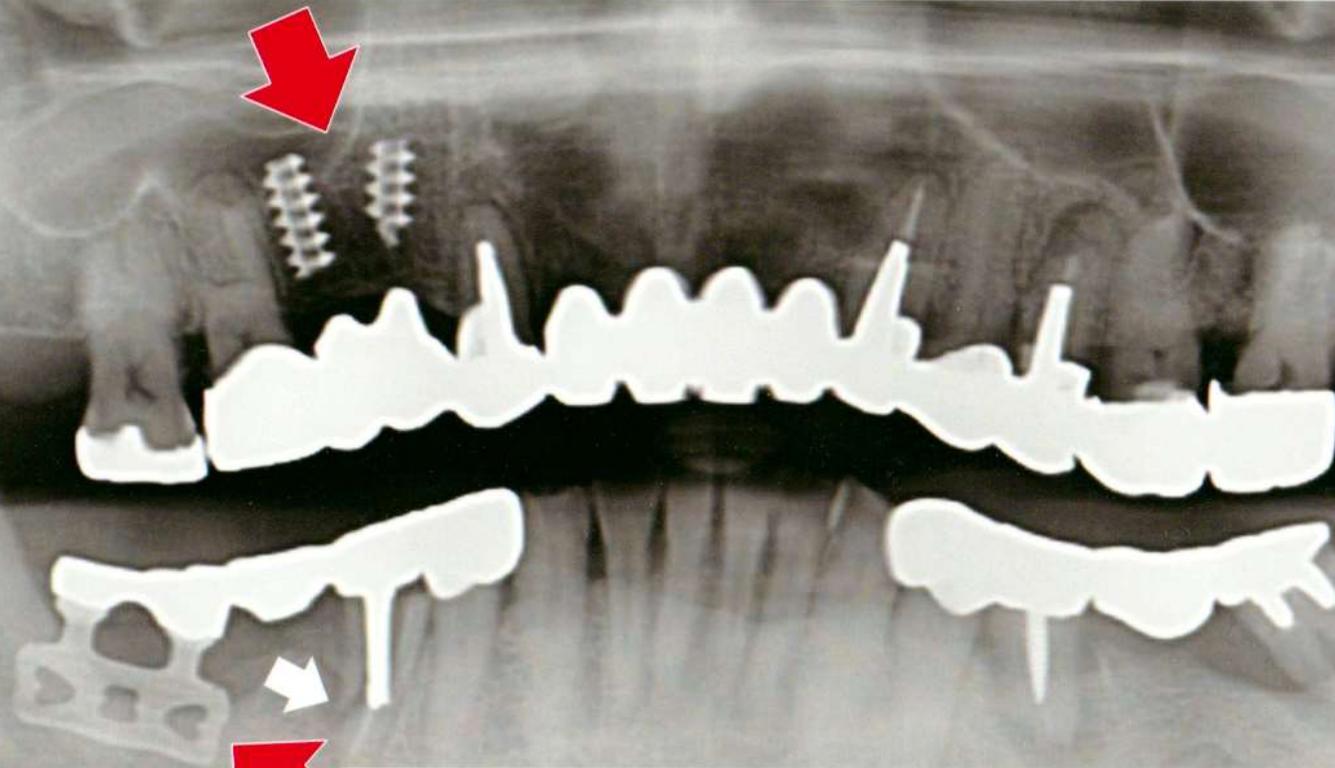

インプラントには色々な形があります。矢印のような土台のインプラントボディもあり、大丈夫そうにも見えますが、このボディの場合は骨への影響も大きく周りの骨が痩せて落ちていってしまいます。また、インプラントと自分の歯を繋げることは、インプラントの世界ではご法度となっており、写真のようにインプラントと自分の歯を繋げた場合、骨が落ちインプラントボディが沈んだ場合、自分の歯も引っ張られ健康な歯も根元から折れてしまいます。(白矢印)